

HZY-HL

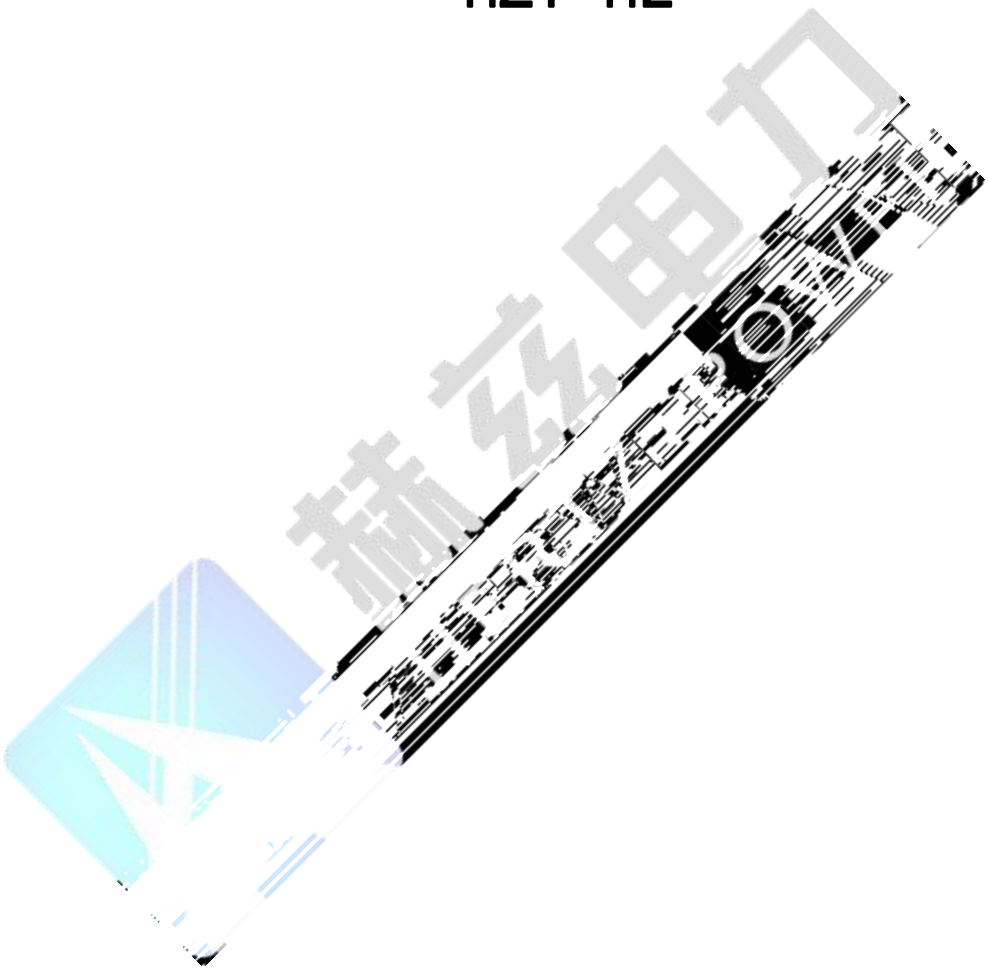

HZY-HL

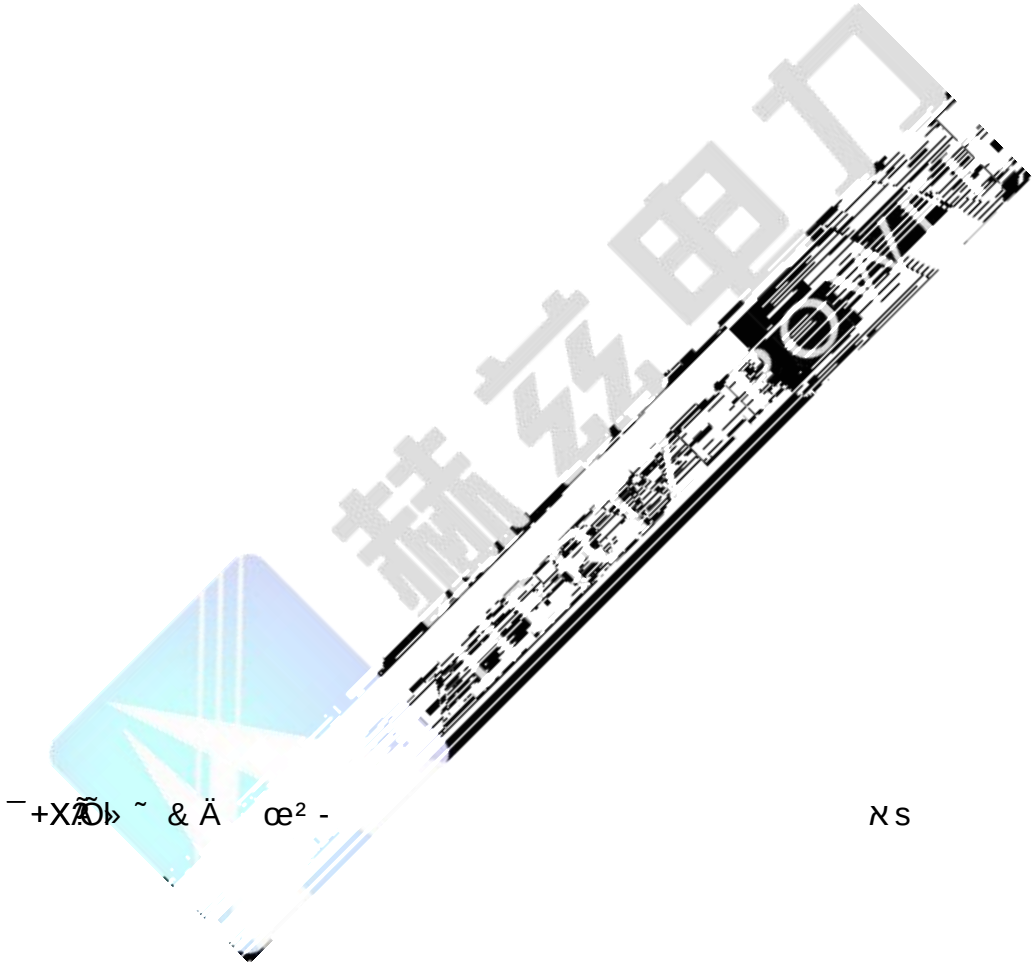

¯+XÃÕl» ˜ & Ä œ² - ʎs

HZY-HL GB/T7599-87

1 8

GB/T7599-87

0.001 1mg KOH/g

≤ ±0.005mg KOH/g


≤0.005mg KOH/g

10 45

≤85%RH

AC220V

500W

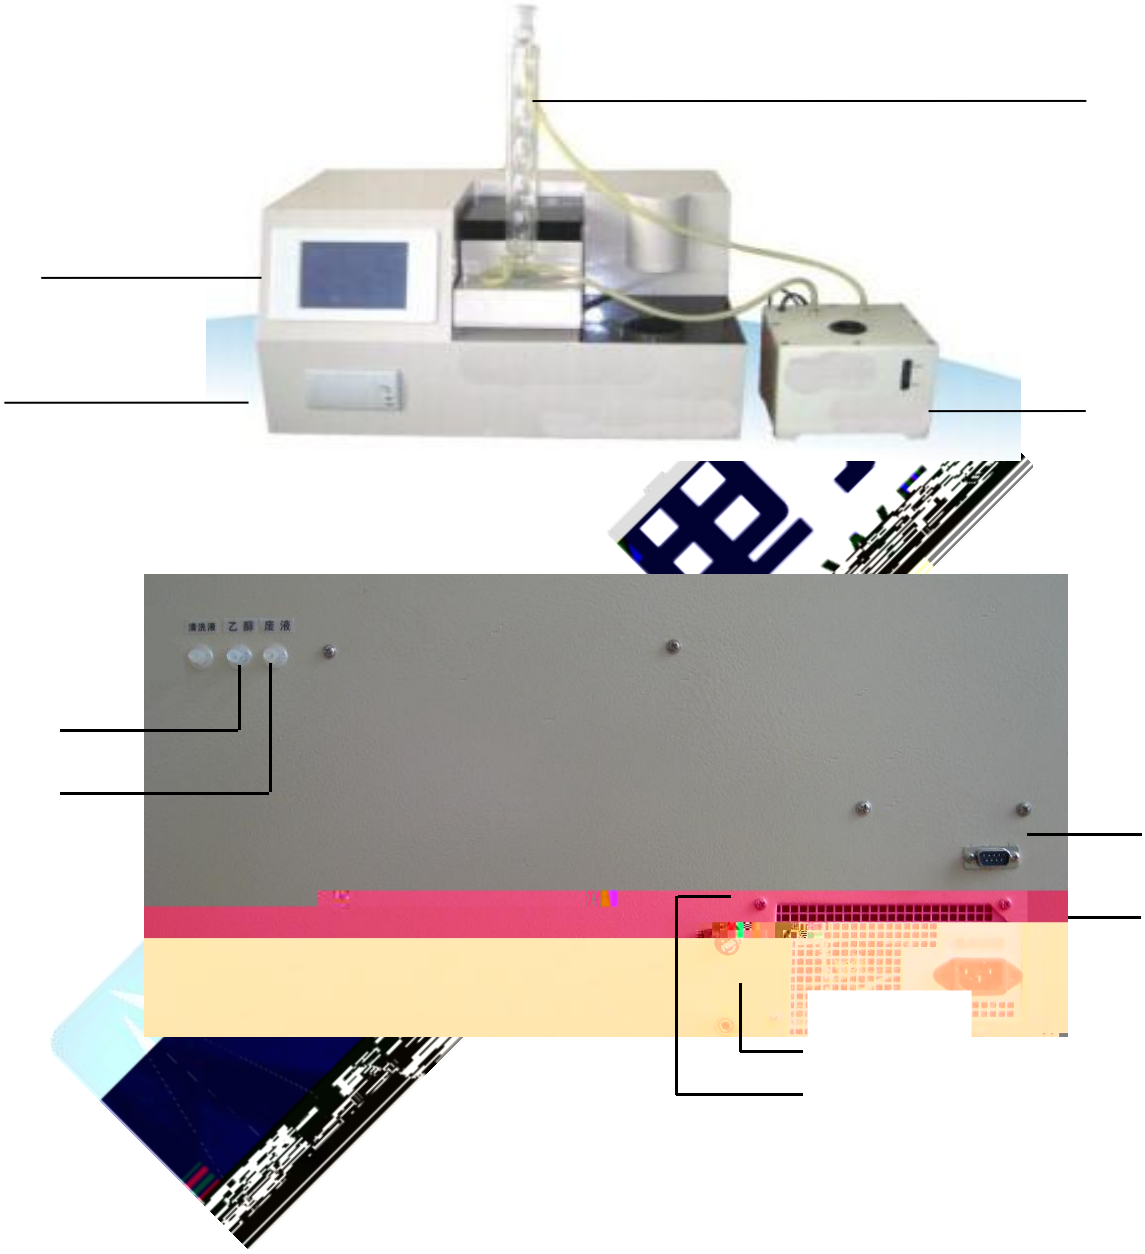

1

2 220V

220V

—KOH BTB (KOH

) BTB

1 :

—KOH 100ml

2 5ml


3 (BTB)

100ml

4 (KOH)

60ml

5 BTB 100ml 1ml

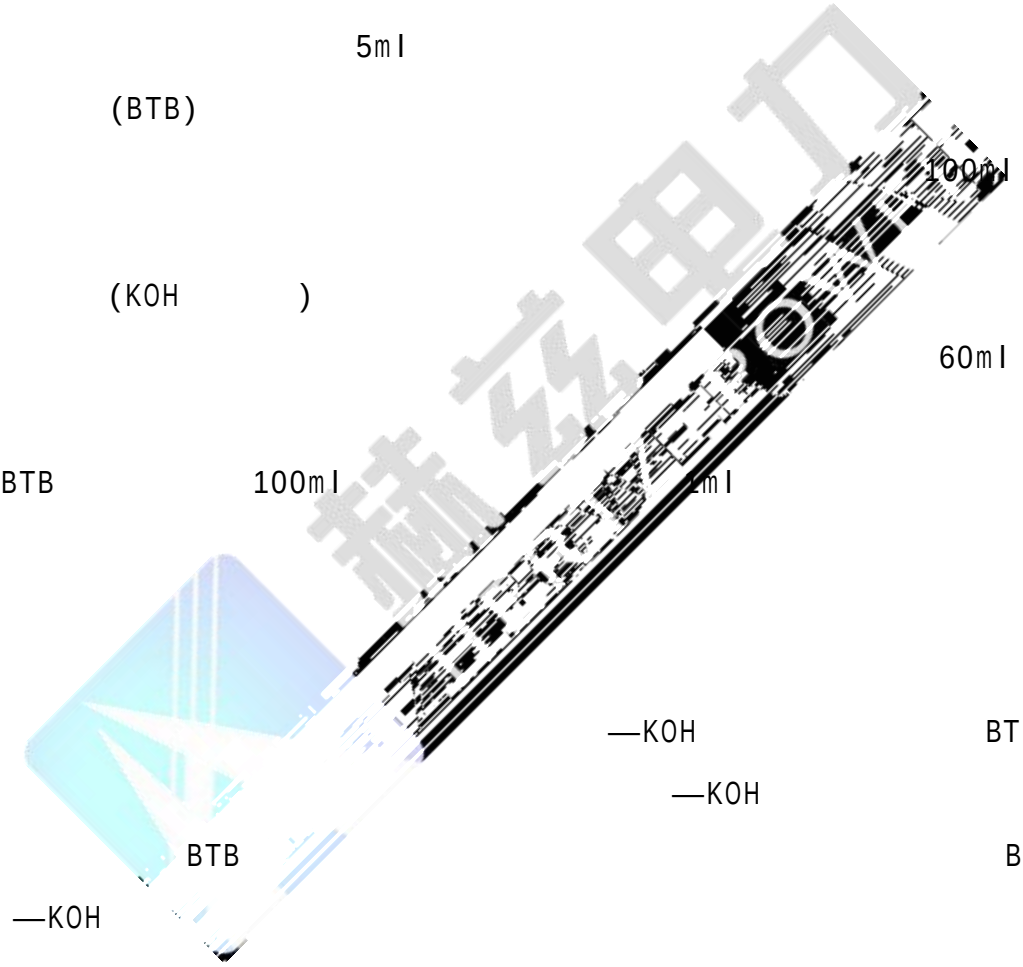


—KOH BTB


—KOH


BTB BTB

—KOH

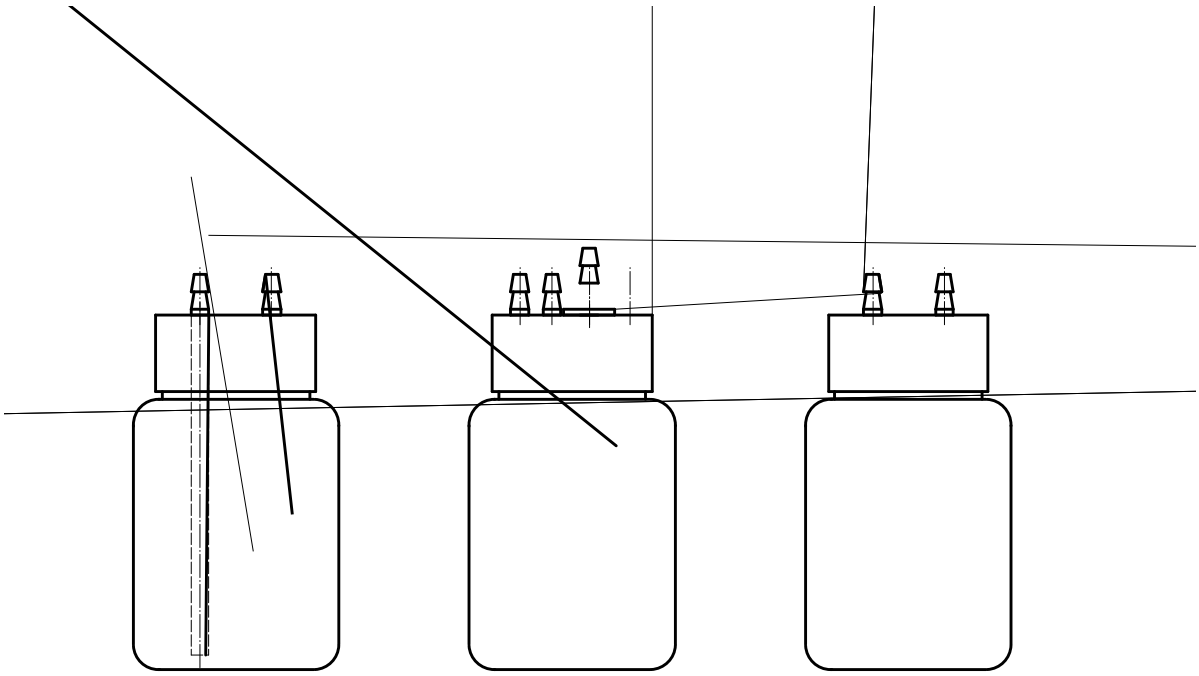




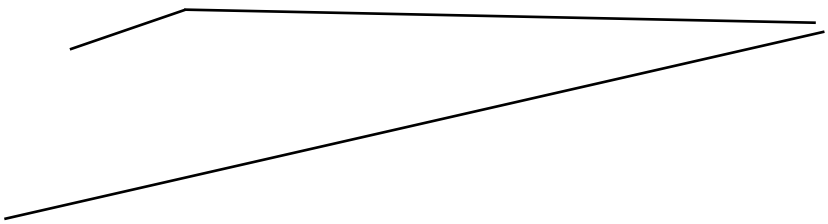


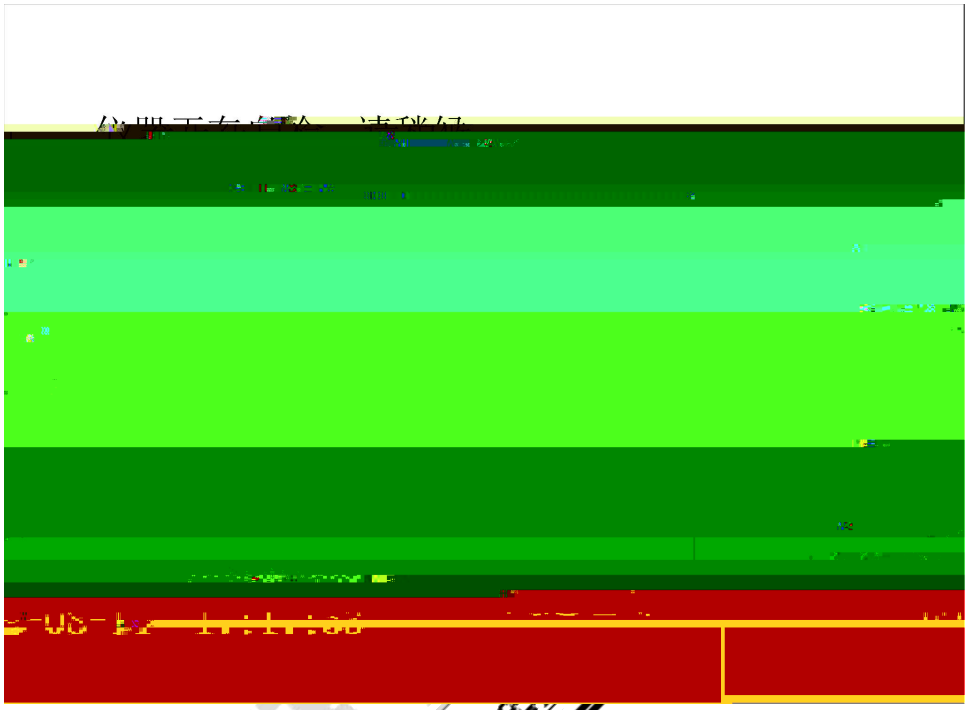


“ ”


□样杯升降装置√
□滴定针管复位√
■滴定门开×
□泵吸反应杯

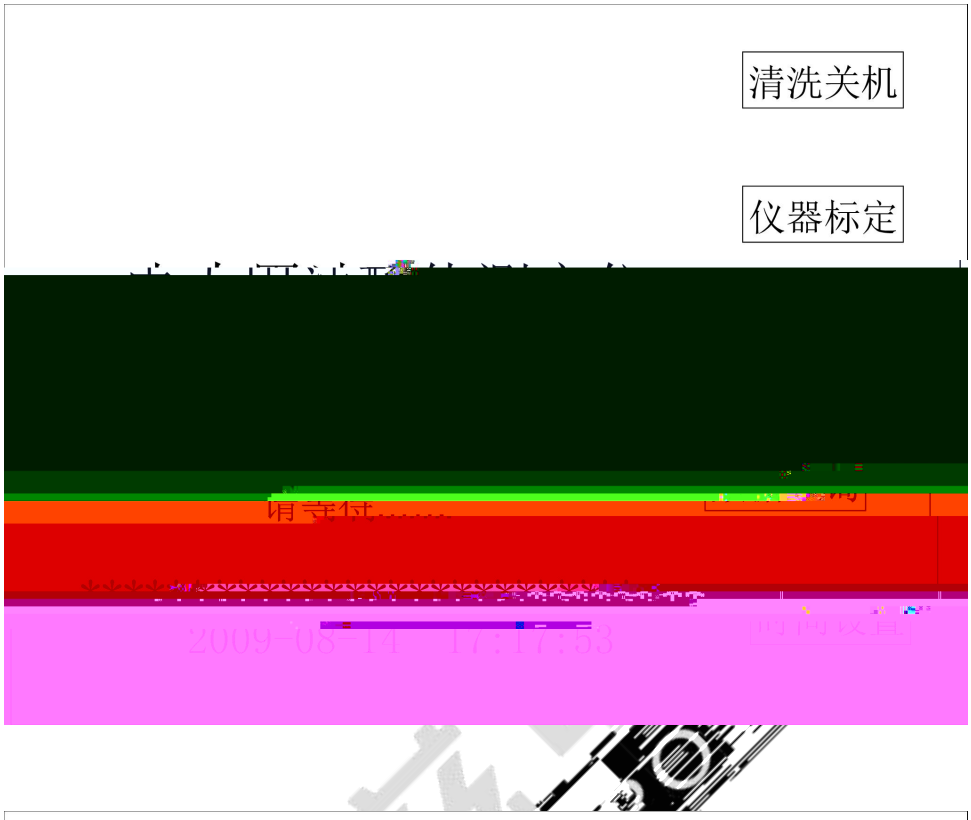

清洗关机
仪器标定

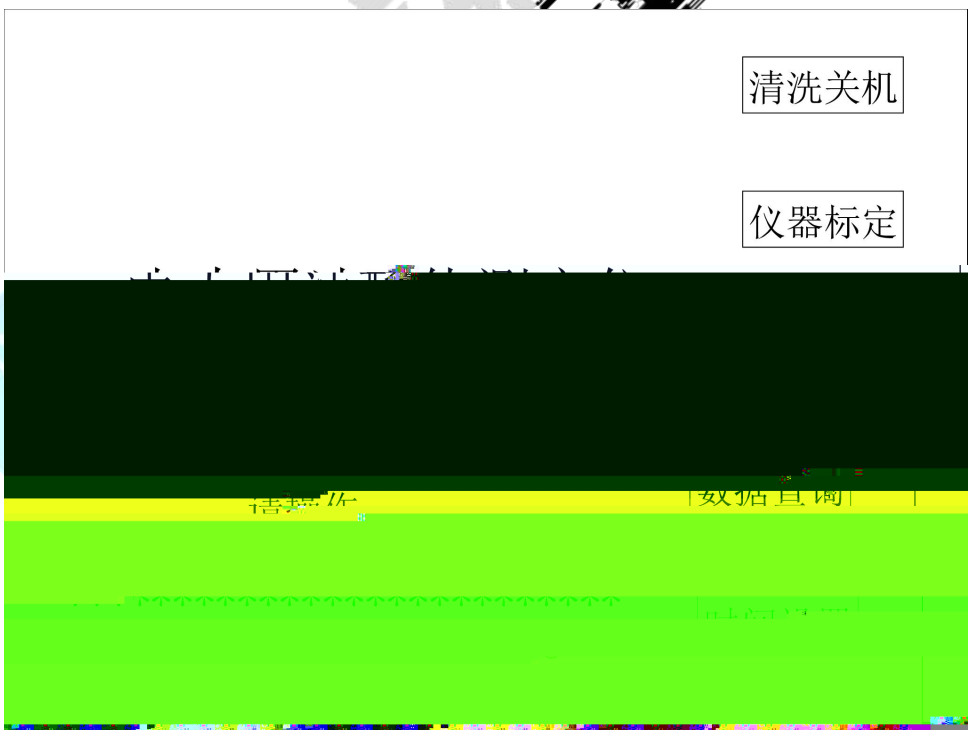
清洗关机
仪器标定

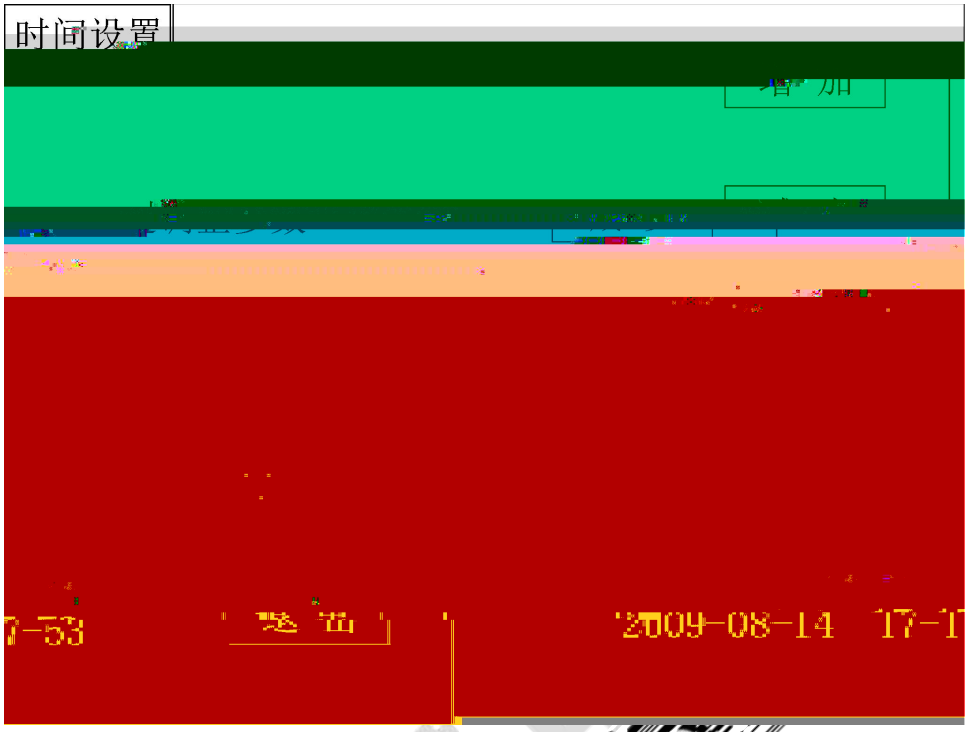


—KOH


“ ”

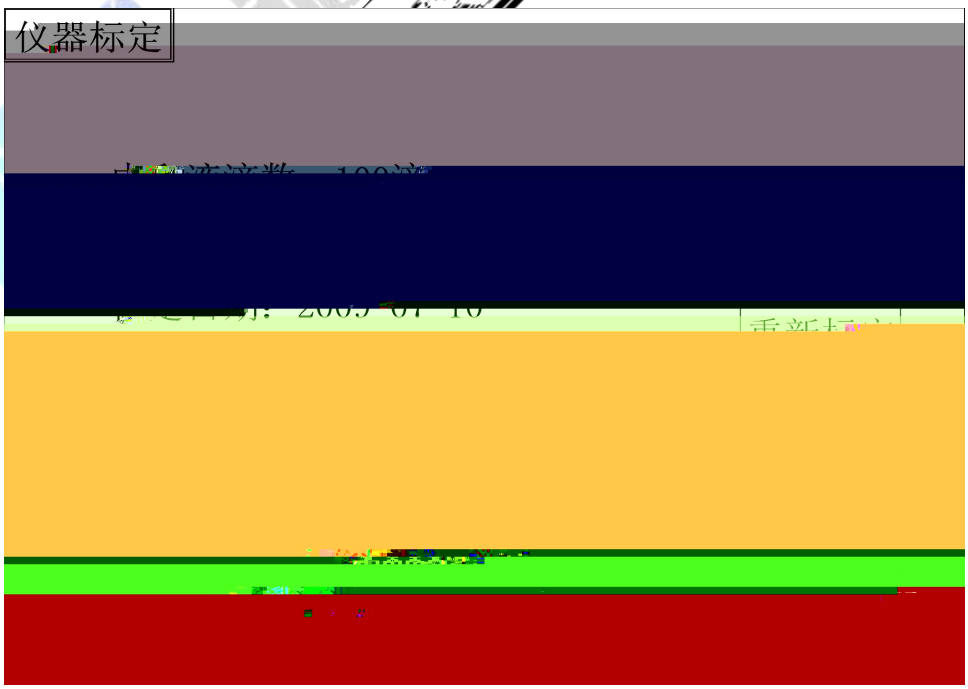


“


”

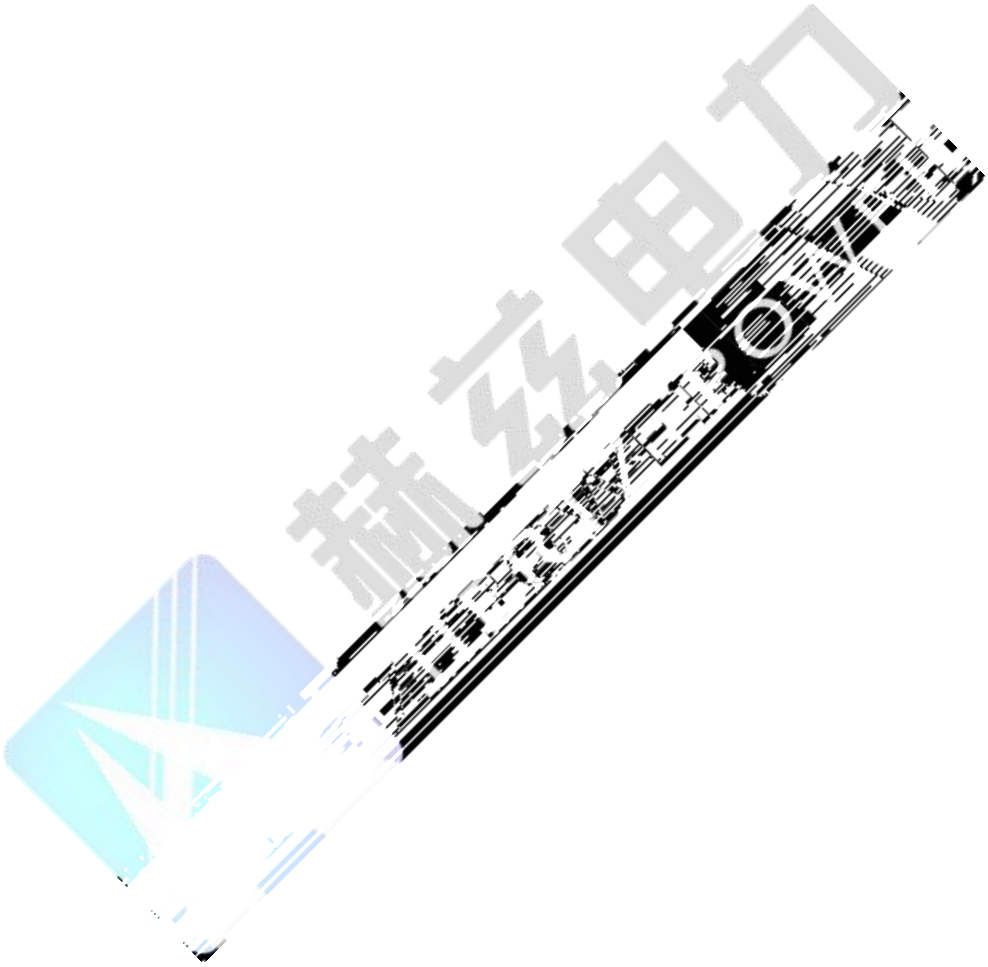


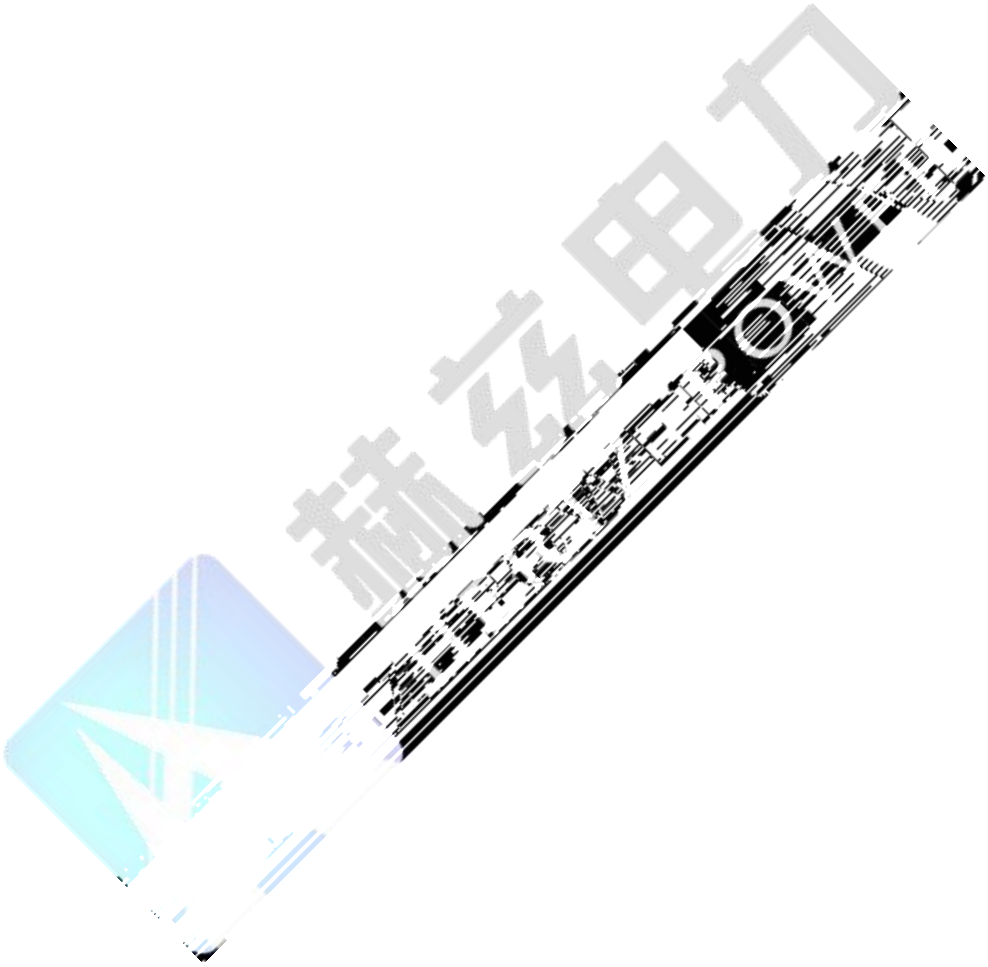


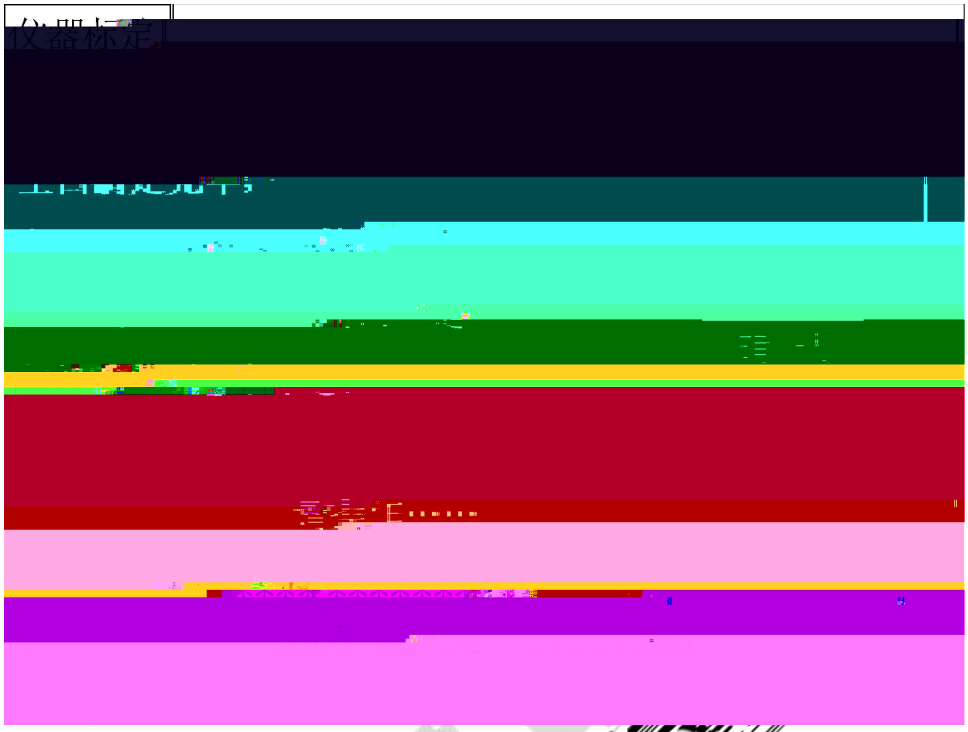


100ul 100ul

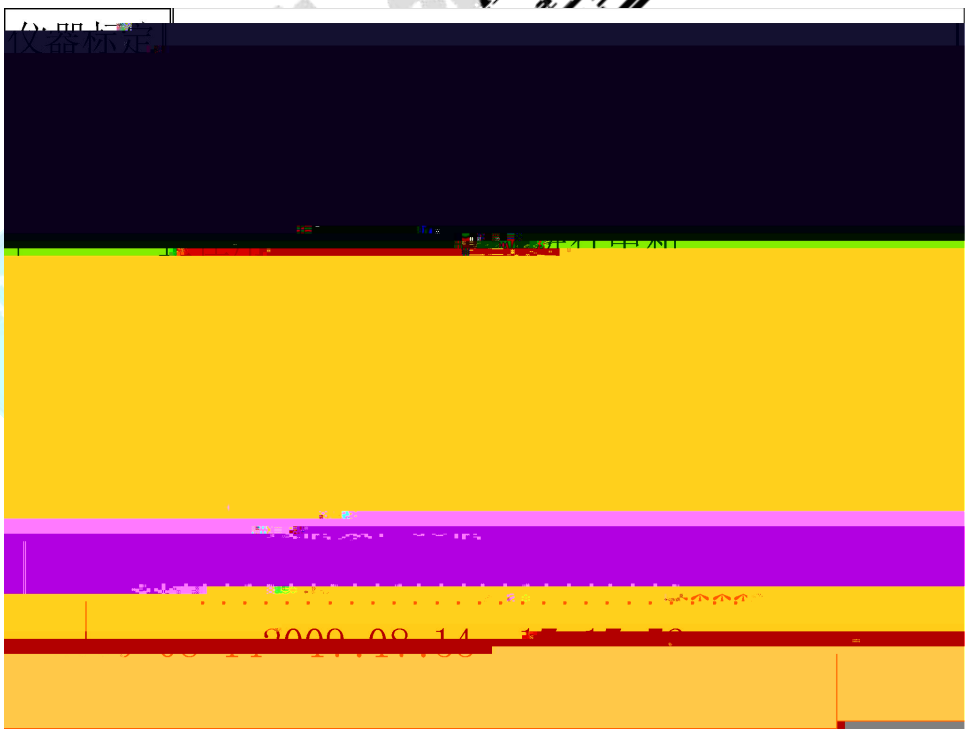

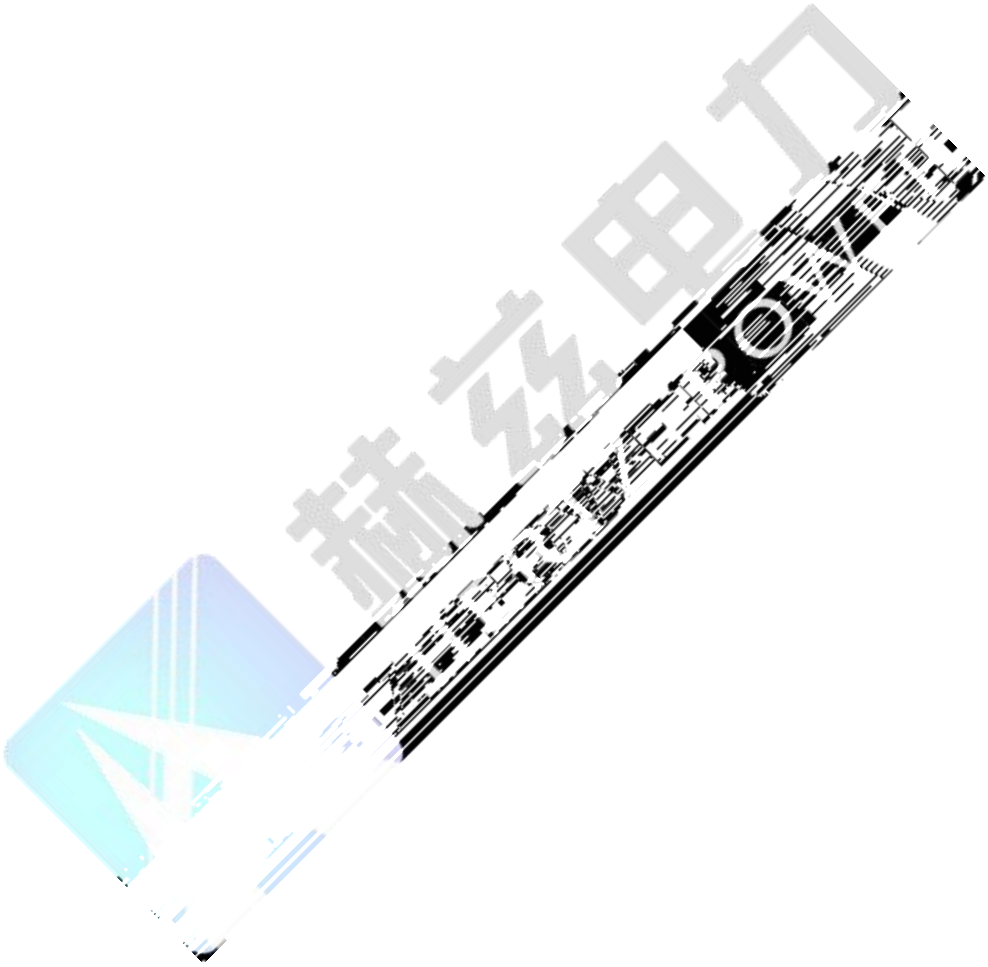

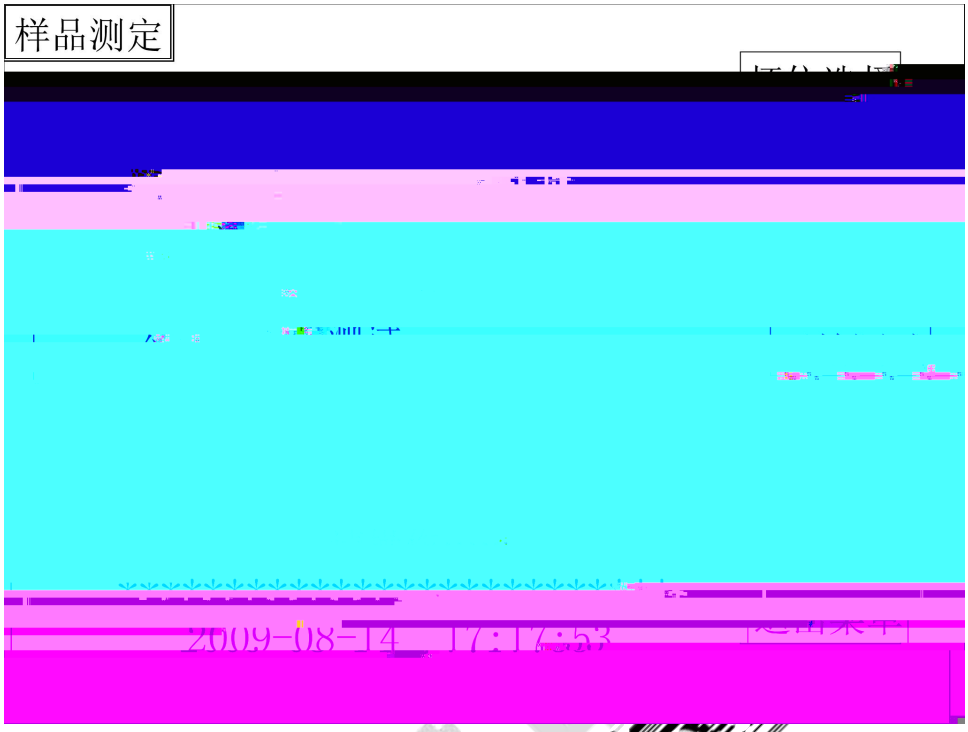

1 8

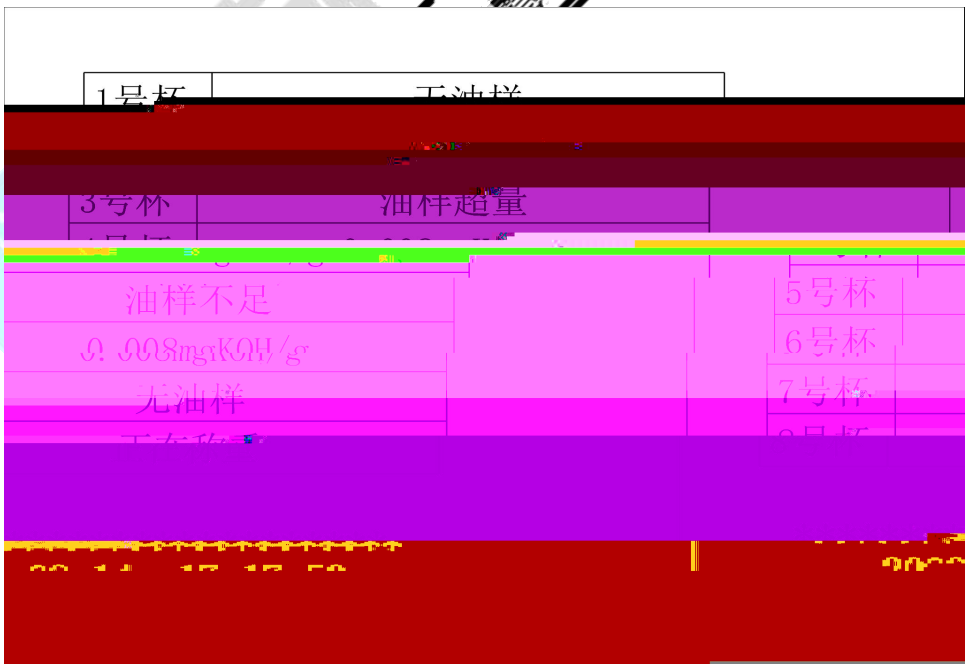

“ ” “ ” “ ”

“ ”

，

1

2

3 80

4 5

5

6


7 5

8

9


1


8

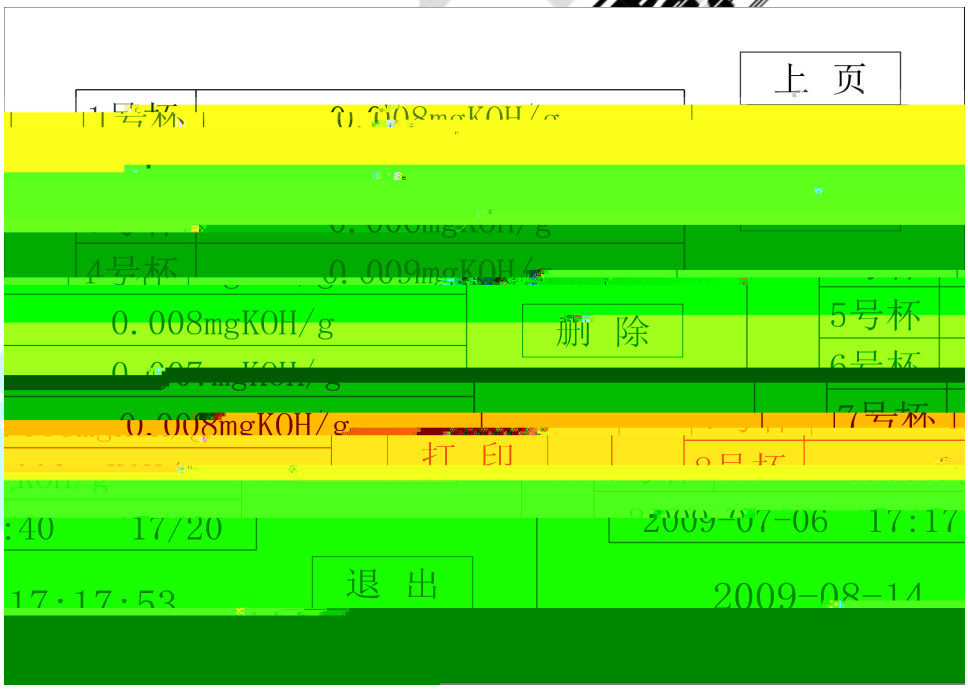

“ ” “ ”

“ ”

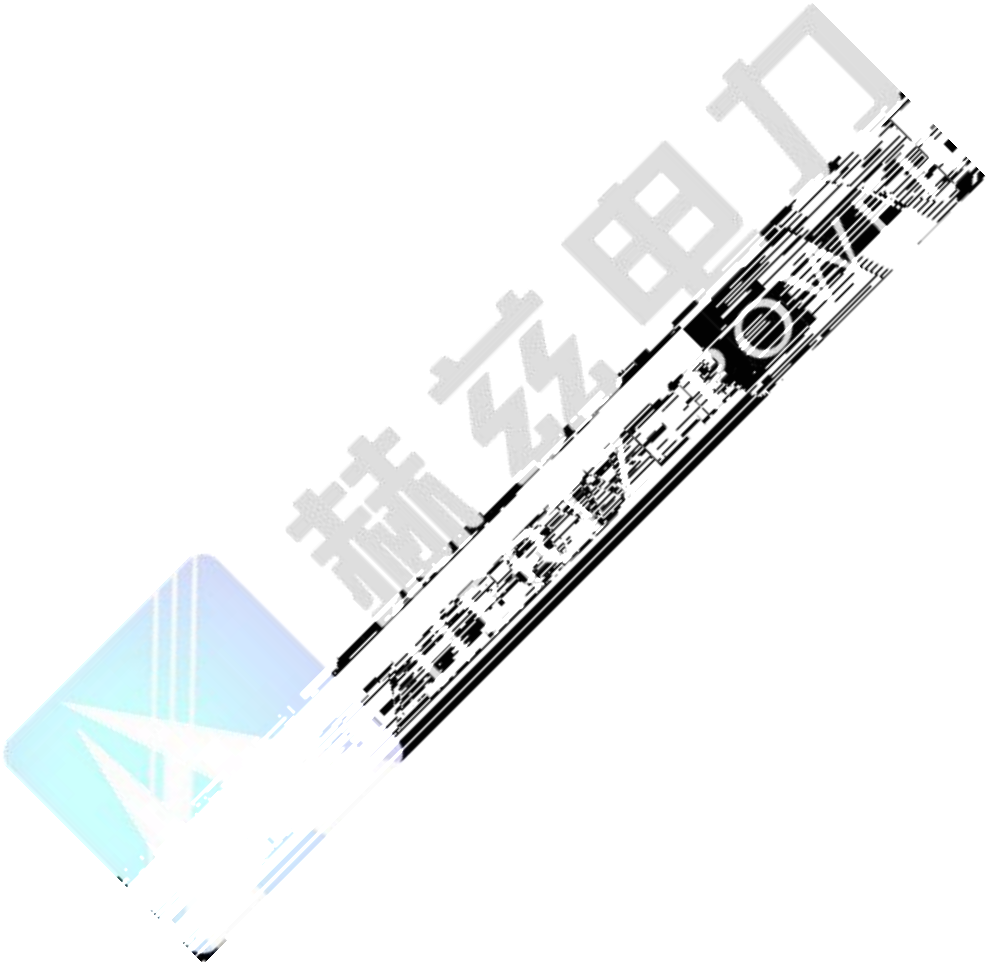


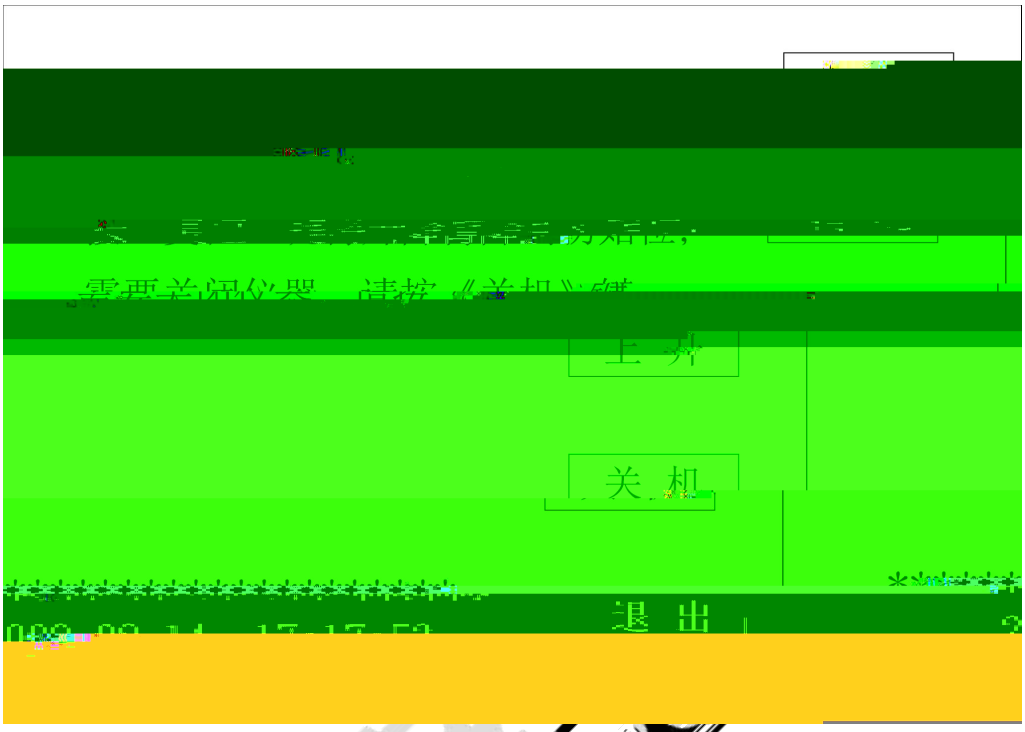

“ ”

“ ”

(—KOH)

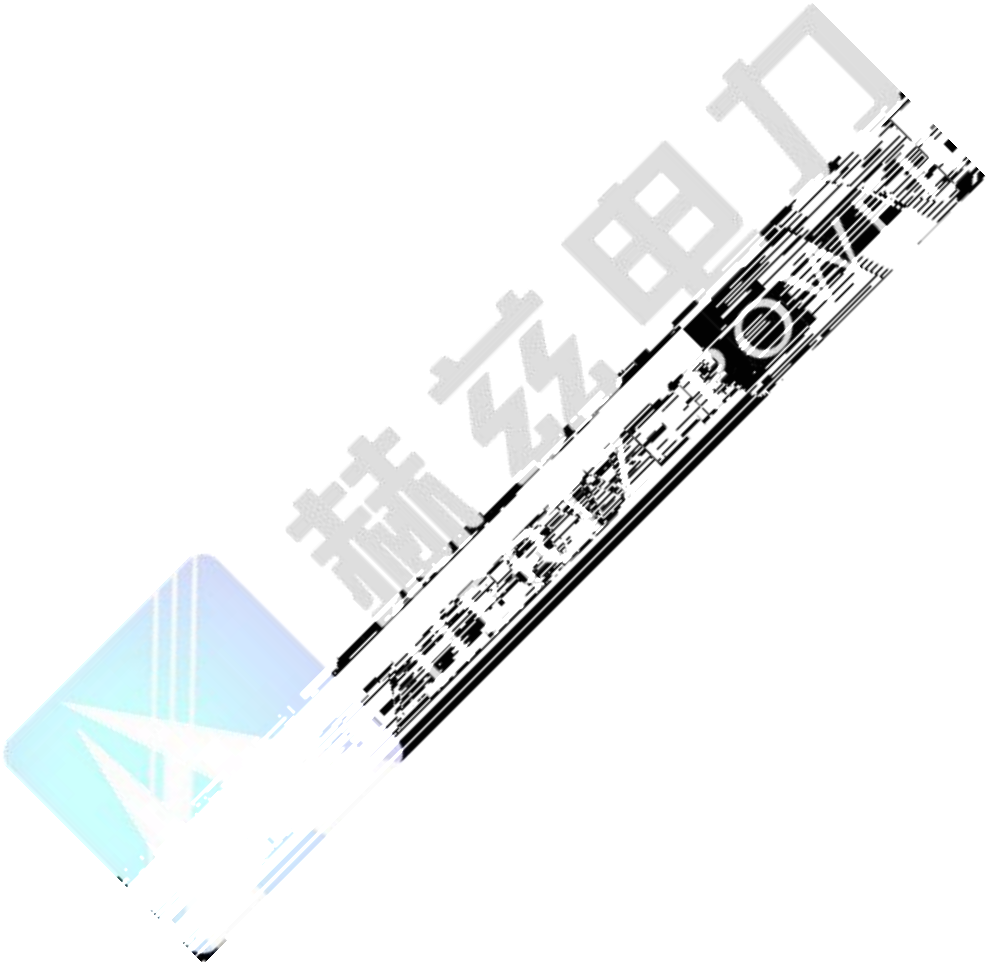


d’ t Ꮒ

” “ ”

À ´Y Ā Į P ﻟﻤ

1

2

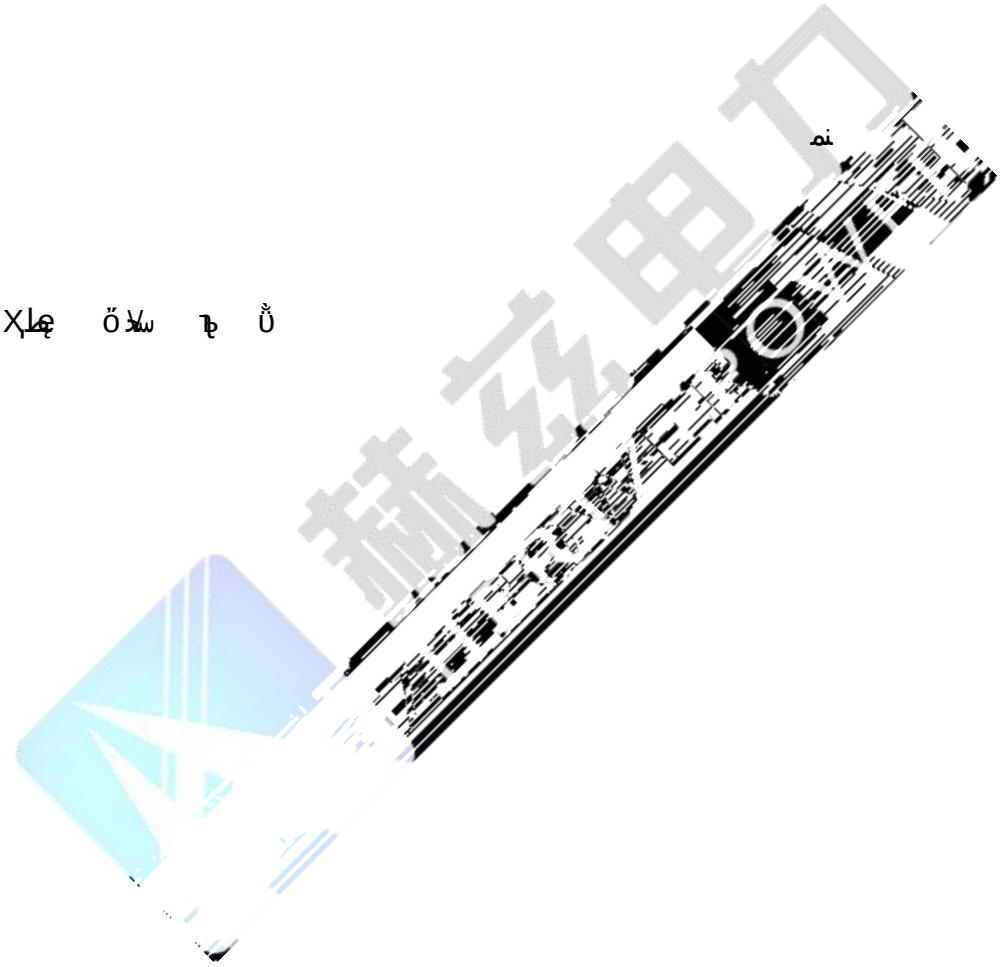

1. q XɬɆ ŏ⅄ѡ ҍ Ǔ